


Kırılan/ Arızalanan Cerrahi Aletlerin Oranı (%)

Gösterge Kodu	KYB_F_18		
Gösterge Tanımı	Sterilizasyonda kırılmış/ arızalı gelen setlerin oransal olarak takibini ifade etmektedir.		
Amaç	Sterilizasyon, paketlenme, set hazırlama gibi süreçlerde alet ve ekipmanlarda gerçekleşen kırılmaları önlemek; hizmet sunumundan dolayı sürece sahip olan sterilizasyon faaliyetlerini iyileştirmektir.		
İlgili Standart	Bölüm Bazlı Göstergeler- Sterilizasyon STR-01		
Hesaplama Yöntemi (Formül)	$\left(\frac{\text{Kırılan/ Arızalanan Cerrahi Alet Sayısı}}{\text{Steril Edilen Toplam Cerrahi Alet Sayısı}} \right) \times 100$		
Eşik Değer	1%		
Alt Göstergeler	Sterilizasyona Kırılmış/ Arızalanmış Gelen Cerrahi Aletlerin Oranı (%)		
Veri Kaynağı	MSÜ Alet İzlem Formu Sterilizasyonda Yapılan Temizlik ve Bakımlarda Oluşan Alet Kırılmaları Gösterge Takip Formu		
Veri Toplama	Periyod	Aylık	
	Toplayan Sorumlu	Bölüm Kalite Sorumlusu	
Veri Doğrulama	☒ Veri Doğrulama Gerekli Değil ☐ Veri Doğrulama Gerekli ise Doğrulama Sorumlusu:		
	Yöntem: Bölüm Sorumlusu tarafından Olay Bildirim sistemine kayıt edilmesi		
Veri Analiz	Periyod	Aylık	
	Analizden Sorumlu(lar)	Kalite Yöneticisi	
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler	Başhekimlik, Hasta Bakım Hizmetleri		
Dikkat Edilecek Hususlar			

AYLAR	Kırılan/ Arızalanan Cerrahi Alet Sayısı	Steril Edilen Toplam Cerrahi Alet Sayısı	Kırılan/Arızalanan Cerrahi Aletlerin Oranı (%)	EŞİK DEĞER	DEĞERLENDİRME VE AKSİYON PLANLARI
OCAK				1%	
ŞUBAT				1%	
MART				1%	
NİSAN				1%	
MAYIS				1%	
HAZİRAN				1%	
TEMMUZ				1%	
AĞUSTOS				1%	
EYLÜL				1%	
EKİM				1%	
KASIM				1%	
ARALIK				1%	

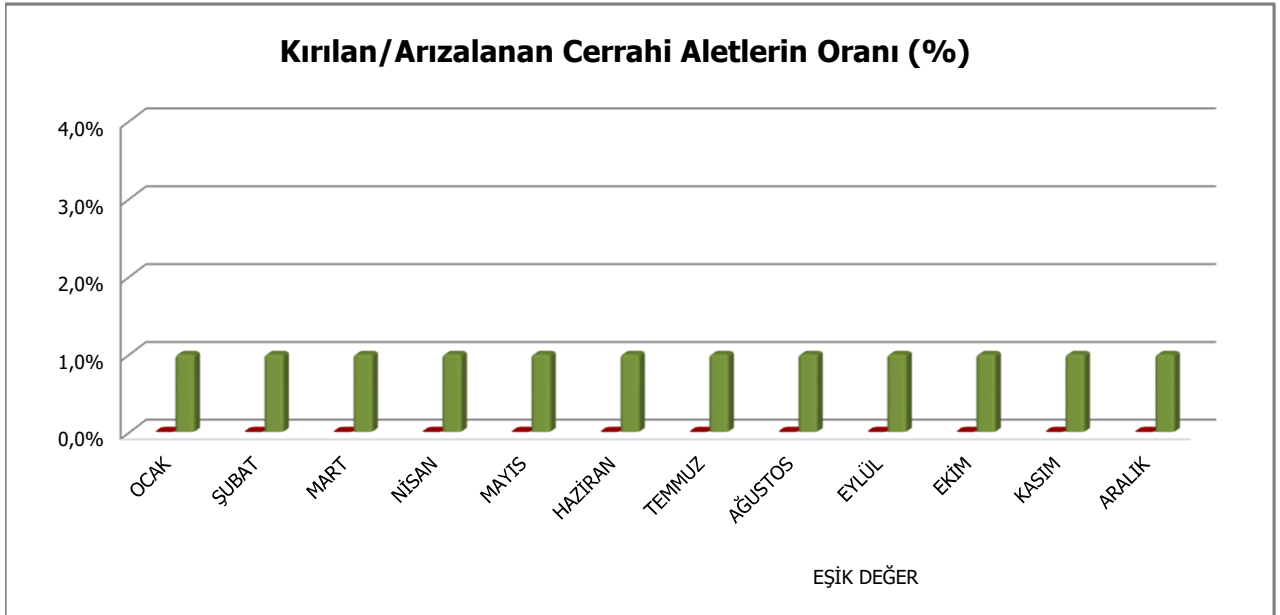


Sterilizasyona Kırılmış/ Arızalanmış Gelen Cerrahi Aletlerin Oranı (%)

Gösterge Kodu	KYB_F_18	
Gösterge Tanımı	Sterilizasyona diğer bölümlerden kırılmış/arızalı gelen cerrahi aletlerin oranını ifade eder.	
Amaç	Sterilizasyona kırılmış/ arızalanmış olarak diğer bölümlerden gelen cerrahi aletlerin takibini sağlamak, süreci iyileştirmektir.	
İlgili Standart	Bölüm Bazlı Göstergeler- Sterilizasyon STR-01	
Hesaplama Yöntemi (Formül)	$\left(\frac{\text{Sterilizasyona Kırılmış/Arızalanmış Gelen Toplam Cerrahi Alet Sayısı}}{\text{Sterilizasyona Gelen Toplam Cerrahi Alet Sayısı}} \times 100$	
Eşik Değer	1%	
Veri Kaynağı	MSÜ Alet İzlem Formu Sterilizasyonda Yapılan Temizlik ve Bakımlarda Oluşan Alet Kırılmaları Gösterge Takip Formu	
Veri Toplama	Periyod	Aylık
	Toplayan Sorumlu	Bölüm Kalite Sorumlusu
Veri Doğrulama	☒ Veri Doğrulama Gerekli Değil ☐ Veri Doğrulama Gerekli ise Doğrulama Sorumlusu:	
	Yöntem: Bölüm Sorumlusu tarafından Olay Bildirim sistemine kayıt edilmesi	
Veri Analiz	Periyod	Aylık
	Analizden Sorumlu(lar)	Kalite Yöneticisi
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler	Başhekimlik, Hasta Bakım Hizmetleri	
Dikkat Edilecek Hususlar		

AYLAR	Sterilizasyona Kırılmış/ Arızalanmış Gelen Toplam Cerrahi Alet Sayısı	Sterilizasyona Gelen Toplam Cerrahi Alet Sayısı	Sterilizasyona Kırılmış/ Arızalanmış Gelen Cerrahi Aletlerin Oranı (%)	EŞİK DEĞER	DEĞERLENDİRME VE AKSİYON PLANLARI
OCAK				1%	
ŞUBAT				1%	
MART				1%	
NİSAN				1%	
MAYIS				1%	
HAZİRAN				1%	
TEMMUZ				1%	
AĞUSTOS				1%	
EYLÜL				1%	
EKİM				1%	
KASIM				1%	
ARALIK				1%	

Sterilizasyona Kırılmış/ Arızalanmış Gelen Cerrahi Aletlerin Oranı (%)

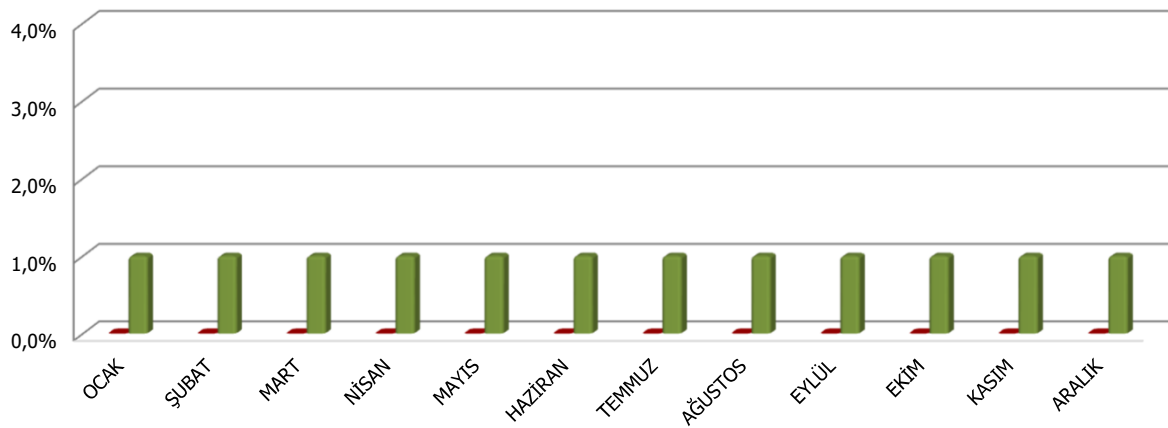




Sterilizasyonda Listeye Göre Eksik Kapatılan Setlerin Oranı (%)

Gösterge Kodu	KYB_F_18		
Gösterge Tanımı	Sterilizasyona gelen setlerin, malzemelerin takibini ifade eder.		
Amaç	Sterilizasyon, paketlenme, set hazırlama gibi süreçlerde setlerin eksik hazırlanmasını önlemek; hizmet sunumundan dolayı sürece sahip olan sterilizasyon faaliyetlerini iyileştirmektir.		
İlgili Standart	Bölüm Bazlı Göstergeler- Sterilizasyon STR-02		
Hesaplama Yöntemi (Formül)	$\left(\frac{\text{Listeye Göre Eksik Kapatılan Set Sayısı}}{\text{Kapatılan Set Sayısı}} \right) \times 100$		
Eşik Değer	3%		
Alt Göstergeler	Sterilizasyon Cihazlarının Performans Oranı (%)		
	Sterilizasyona Uygun/ Eksik Gelen Cerrahi Aletlerin Oranı (%)		
Veri Kaynağı	MSÜ Alet İzlem Formu		
Veri Toplama	Periyod	Aylık	
	Toplayan Sorumlu	Bölüm Kalite Sorumlusu	
Veri Doğrulama	☒ Veri Doğrulama Gerekli Değil ☐ Veri Doğrulama Gerekli ise Doğrulama Sorumlusu:		
	Yöntem:		
Veri Analiz	Periyod	Aylık	
	Analizden Sorumlu(lar)	Kalite Yöneticisi	
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler	Başhekimlik, Hasta Bakım Hizmetleri		
Dikkat Edilecek Hususlar	Sterilizasyondaki set listelerinin doğru kontrol edilmesi		

AYLAR	Listeye Göre Eksik Kapatılan Set Sayısı	Kapatılan Set Sayısı	Sterilizasyonda Listeye Göre Eksik Kapatılan Setlerin Oranı (%)	EŞİK DEĞER	DEĞERLENDİRME VE AKSİYON PLANLARI
OCAK				3%	
ŞUBAT				3%	
MART				3%	
NİSAN				3%	
MAYIS				3%	
HAZİRAN				3%	
TEMMUZ				3%	
AĞUSTOS				3%	
EYLÜL				3%	
EKİM				3%	
KASIM				3%	
ARALIK				3%	

Sterilizasyonda Listeye Göre Eksik Kapatılan Setlerin Oranı (%)

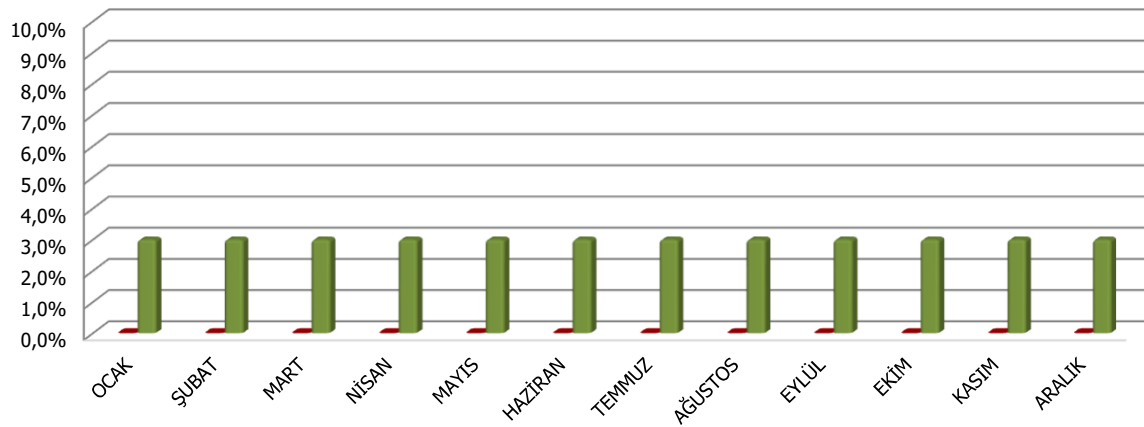


Sterilizasyon Cihazlarının Performans Oranı (%)

Gösterge Kodu	KYB_F_18	
Gösterge Tanımı	Sterilizasyon cihazlarının performansı ile iş gücü kaybının oransal takibini ifade eder.	
Amaç	Sterilizasyon, paketlenme, set hazırlama gibi süreçlerde setlerin eksik hazırlanmasını önlemek; hizmet sunumunda iş gücünü etkileyeceğinden dolayı sürece dahil olan sterilizasyon cihazlarının performansının takibini sağlamaktır.	
İlgili Standart	Bölüm Bazlı Göstergeler- Sterilizasyon STR-02	
Hesaplama Yöntemi (Formül)	$\left(\frac{\text{Cihazın Toplam Arıza Süresi}}{\text{Cihazın Toplam Çalışma Süresi}} \right) \times 100$	
Eşik Değer	3%	
Veri Kaynağı	MSÜ Alet İzlem Formu	
Veri Toplama	Periyod	Aylık
	Toplayan Sorumlu	Bölüm Kalite Sorumlusu
Veri Doğrulama	☒ Veri Doğrulama Gerekli Değil ☐ Veri Doğrulama Gerekli ise Doğrulama Sorumlusu:	
	Yöntem:	
Veri Analiz	Periyod	Aylık
	Analizden Sorumlu(lar)	Kalite Yöneticisi
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler	Başhekimlik, Hasta Bakım Hizmetleri	
Dikkat Edilecek Hususlar		

AYLAR	Cihazın Toplam Arıza Süresi	Cihazın Toplam Çalışma Süresi	Sterilizasyon Cihazlarının Performans Oranı (%)	EŞİK DEĞER	DEĞERLENDİRME VE AKSİYON PLANLARI
OCAK				3%	
ŞUBAT				3%	
MART				3%	
NİSAN				3%	
MAYIS				3%	
HAZİRAN				3%	
TEMMUZ				3%	
AĞUSTOS				3%	
EYLÜL				3%	
EKİM				3%	
KASIM				3%	
ARALIK				3%	

Sterilizasyon Cihazlarının Performans Oranı (%)

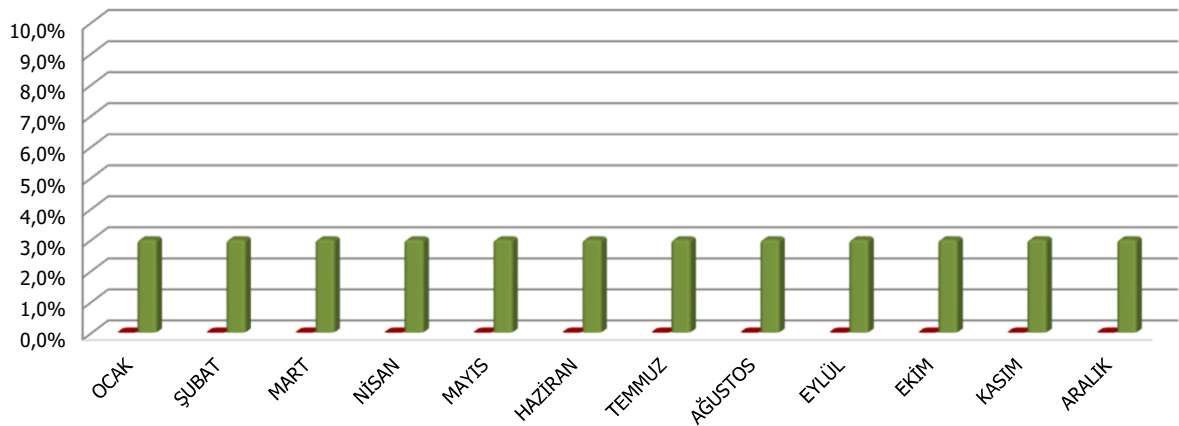

Sterilizasyon Cihazlarının Performans Oranı (%)

Sterilizasyona Uygunsuz/ Eksik Gelen Cerrahi Aletlerin Oranı (%)

Gösterge Kodu	KYB_F_18	
Gösterge Tanımı	Sterilizasyona uygunsuz/ eksik gelen cerrahi aletlerin oransal takibini (setlerden kıl, çöp çıkması gibi) ifade eder.	
Amaç	Sterilizasyona bölümlerden gelen cerrahi aletlerin eksikliği nedeniyle envanter kayıplarını takip etmek ve süreci iyileştirmektir.	
İlgili Standart	Bölüm Bazlı Göstergeler- Sterilizasyon STR-02	
Hesaplama Yöntemi (Formül)	$\left(\frac{\text{Sterilizasyona Uygunsuz/ Eksik Gelen Toplam Cerrahi Alet Sayısı}}{\text{Sterilizasyona Gelen Toplam Cerrahi Alet Sayısı}} \times 100 \right)$	
Eşik Değer	3%	
Veri Kaynağı	MSÜ Alet İzlem Formu	
Veri Toplama	Periyod	Aylık
	Toplayan Sorumlu	Bölüm Kalite Sorumlusu
Veri Doğrulama	☒ Veri Doğrulama Gerekli Değil ☐ Veri Doğrulama Gerekli ise Doğrulama Sorumlusu:	
	Yöntem: Bölüm Sorumlusu tarafından Olay Bildirim sistemine kayıt edilmesi	
Veri Analiz	Periyod	Aylık
	Analizden Sorumlu(lar)	Kalite Yöneticisi
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler	Başhekimlik, Hasta Bakım Hizmetleri	
Dikkat Edilecek Hususlar		

AYLAR	Sterilizasyona Uygunuz/ Eksik Gelen Toplam Cerrahi Alet Sayısı	Sterilizasyona Gelen Toplam Cerrahi Alet Sayısı	Sterilizasyona Uygunuz/ Eksik Gelen Cerrahi Aletlerin Oranı (%)	EŞİK DEĞER	DEĞERLENDİRME VE AKSİYON PLANLARI
OCAK				3%	
ŞUBAT				3%	
MART				3%	
NİSAN				3%	
MAYIS				3%	
HAZİRAN				3%	
TEMMUZ				3%	
AĞUSTOS				3%	
EYLÜL				3%	
EKİM				3%	
KASIM				3%	
ARALIK				3%	

